

Испытательная лаборатория фармакокинетики и контроля качества лекарственных средств ЗАО «Группа компаний «Медси»

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21 ФЛ 47 от 14. 02. 2014 г. по 14. 02. 2019 г.
Юридический адрес: 123056 пер. Грузинский д. 3 а, тел/факс. (495) 621-22-23

Фактический адрес: 143442, Московская область, Красногорский район, п. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-ой км ☎ тел. 759-91-49

«25» апреля 2014 г.

«Утверждаю»

Заведующий лабораторией фармакокинетики и контроля качества лекарственных средств
д.м.н. Г.Н. Шарапов



ОТЧЁТ

по научно-исследовательской работе «Исследование устойчивости лонгидазы к действию импульсных токов аппарата медицинского для трансдермального введения лекарственных веществ «Farma T.E.V. Trans Epidermal Barrier Physio», модель FTE1/-D, производства Италия» по договору №154-14 от 16 апреля 2014 г.

Исполнители:

Заведующий лабораторией фармакокинетики и контроля качества лекарственных средств. д.м.н., Заслуженный врач РФ

Ведущий специалист ЛФККЛС в области хроматографии и спектроскопии



Г.Н. Шарапов

А.Л. Попов

Москва – 2014

Введение

Одним из основных направлений развития современной физиотерапии является исследование механизмов лечебного действия природных и искусственных физических факторов и *научное обоснование* новых физических методов лечения.

Лекарственный электрофорез является динамически развивающимся физиотерапевтическим методом, который постоянно пополняется не только новыми частными методиками, но и принципиально новыми и оригинальными технологиями.

Так, электродный фармафорез – инновационная разновидность лекарственного электрофореза, основан на трансдермальном введении лекарственных веществ под действием импульсных токов сложной формы. Основными преимуществами электродного фармафореза является увеличение биодоступности и адресной доставки действующих веществ к очагу поражения, эффективное введение в организм высокомолекулярных соединений, минимальное воздействие на эндокринную систему, отсутствие системных и местных побочных эффектов.

Методология разработки частных методик лекарственного электрофореза, включая и электродный фармафорез, предусматривает исследование устойчивости лекарственных веществ к действию электрического тока.

Цель исследования

Целью настоящего исследования явилось изучение действия импульсных токов сложной формы, получаемых на аппаратном комплексе Farma T.E.V., на сложное органическое вещество: лонгидаза препаративным (жидкостная хроматография или ВЭЖХ и физико-химическим (УФ-спектрофотометрия) методами.

Материалы и методы исследования

Лонгидаза

Лиофилизированная субстанция (конъюгат гиалуронидазы с сополимером N-оксида 1,4-этиленпиперазина и (N-карбоксиметил)-1,4-этиленпиперазиний бромида) растворима в воде и в 0,5% растворе прокаина.

Аппаратный комплекс «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модель FTE1/P-D (Италия). В аппарате используется однонаправленный пульсирующий итеративный ток сложной формы импульсов, диапазон выходного напряжения – от 0 до 3,5 В, частота модуляции – 350 Гц – 50 кГц, диапазон тока – от 0 до 7 мА.

Регистрирующий ультрафиолетовый спектрофотометр «Evolution 300» «Thermo scientific» (Великобритания), кварцевые кюветы с толщиной слоя 10 мм ($c = 10^{-2}$), электронные аналитические весы Precisa (Швейцария), фильтры Millipor-0,45 μ (США), изократическая система ВЭЖХ «Bischoff» (Германия),

Рабочие водные растворы готовили в концентрации 0,1 г/мл.

Для этого точную навеску (10 г) каждого вещества растворяли в 100 мл воды очищенной, качество которой соответствовало ФС 42-0324-09, при 37°C. Полученные рабочие растворы каждого анализируемого вещества делили на 2 части, одну из которых оставляли для контроля, вторую – подвергали действию электрического тока. Анализ рабочих растворов (до и после действия тока) проводили на УФ-спектрофотометре при комнатной температуре в диапазонах волн от 190 до 700 нм, а также подвергали ВЭЖХ анализу в системах: хлороформ – этанол – вода (10:5:1 по объему); ацетонитрил – ледяная уксусная кислота – вода (5:5:10) и *n*-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (12:3:5) с добавками триэтиламина и диметилсульфоксида. Для исследования действия тока рабочие растворы помещали в лабораторные стаканы объёмом 250 мл, опускали в них металлические электроды аппарата «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier

Physio», модель FTE1/P-D, на панели управления которого была выставлена интенсивность 20 в режиме «Артрит, артроз». Через 10 мин. электроды извлекали и вновь проводили физико-химические исследования рабочих растворов ранее описанными методами ВЭЖХ и УФ-спектрофотометрии.

Результаты и их обсуждение

В УФ-спектре раствора лонгидазы имеются два характеристических пика поглощения в области 220 ± 2 нм и в области 231 ± 2 нм (рис. 3). После действия электрического тока на УФ-спектре рабочего раствора лонгидазы (кривая 2) оба пика проявляют несколько меньшую оптическую плотность и второй пик образует отчётливо видимое плечо при 234 нм,

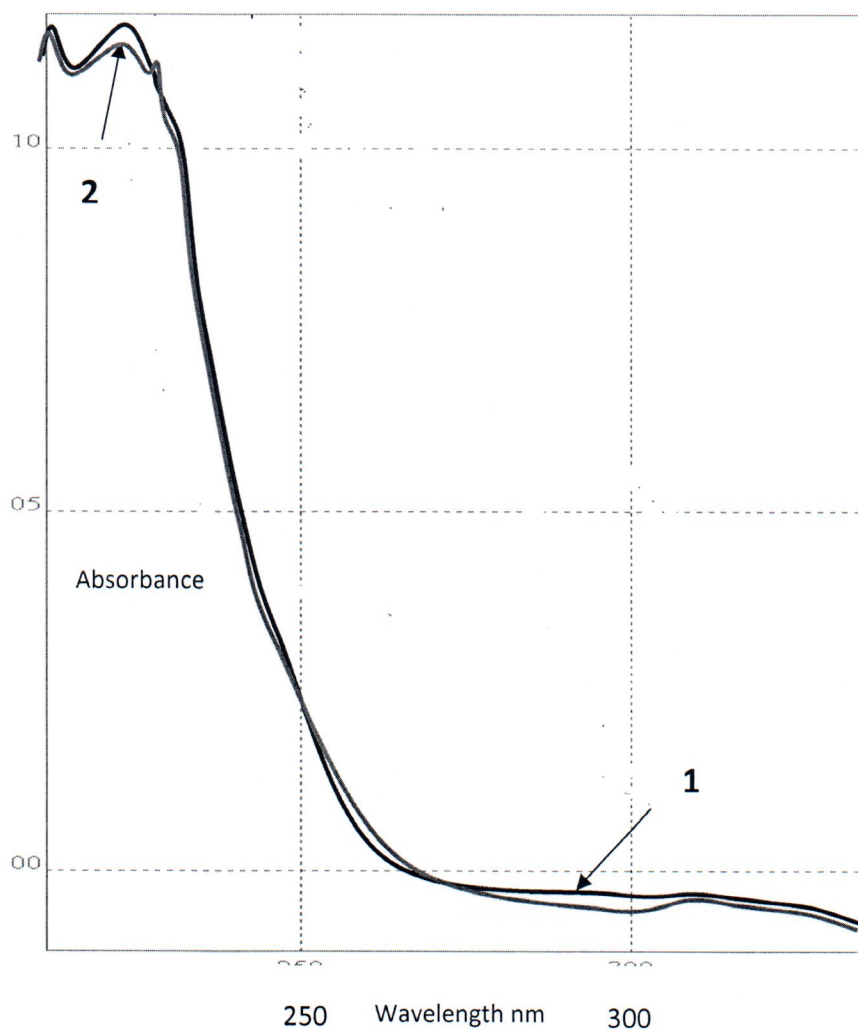


Рис.4. УФ-спектры растворов лонгидазы

1 – рабочий раствор до действия электрического тока; **2** – рабочий раствор после 10 мин. действия импульсных токов сложной формы, получаемых на аппаратном комплексе «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модели FTE1/P-D (Италия);

Наряду с методом УФ-спектрофотометрии нами был использован сравнительный метод ВЭЖХ. При использовании системы растворителей разной полярности: хлороформ – этанол – вода (10:5:1), все четыре анализируемых вещества до и после действия электрического тока не элюировали (как до, так и после действия тока). Никаких пиков данных веществ в видимой области и при облучении УФ-лампой на выходе не обнаружено.

При использовании второй системы растворителей: ацетонитрил – ледяная уксусная кислота – вода (5:5:10), при скорости прохождения элюента 0.65 мл/мин, наблюдались ярко-выраженные хроматограммы с временами выхода 3,4 мин, 2,9 мин, 4,2 мин 3,75 для лорноксикама, лонгидазы, кетопрофена и толперизона соответственно. Так же, как и в первом случае, никаких значительных смещений времени выхода для этих же подвергшихся действию тока, не было выявлено. Длина волны для ультрафиолетового детектора $\lambda = 236$ нм

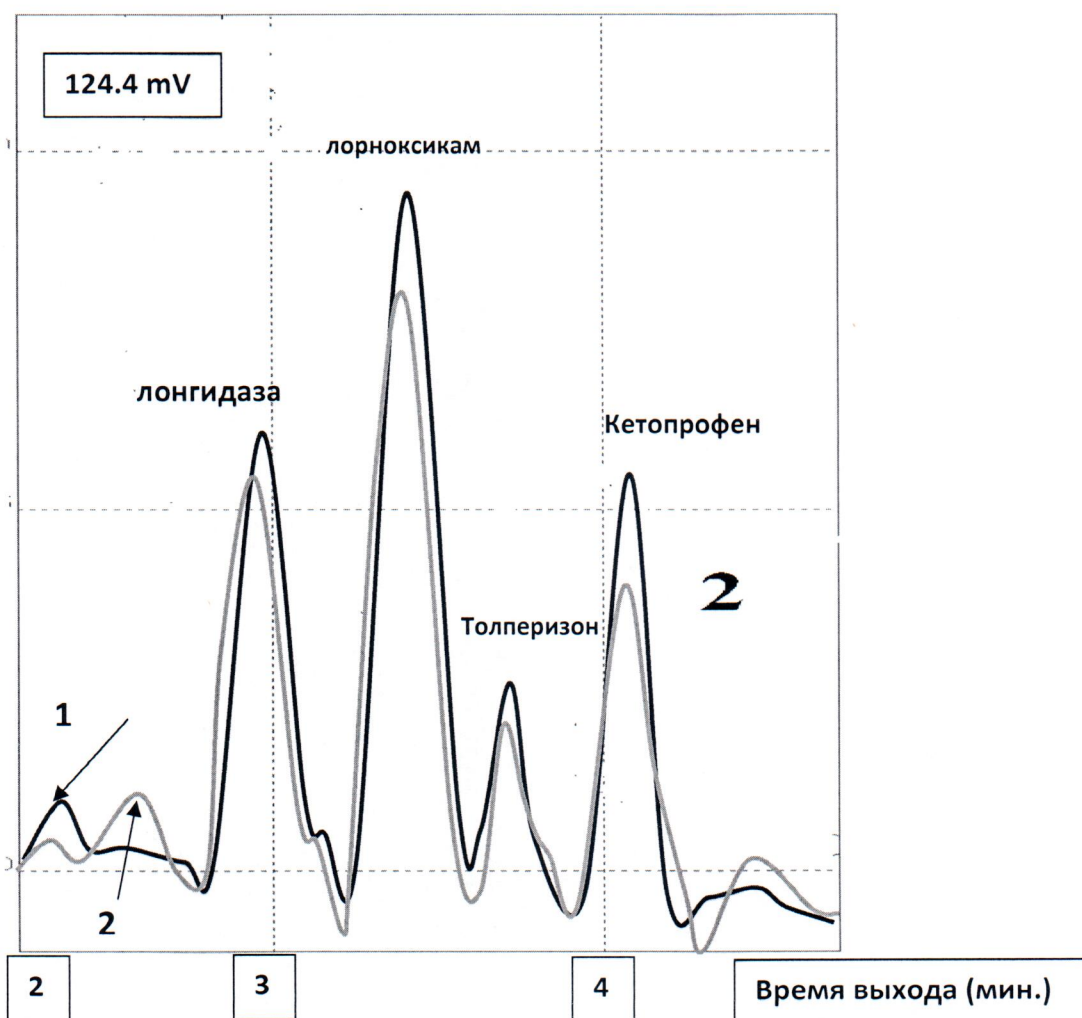


Рис.4. Интегральная хроматограмма исследуемых веществ

1 – рабочий раствор до действия электрического тока; 2 – рабочий раствор после 10 мин. действия импульсных токов сложной формы, получаемых на аппаратном комплексе «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модели FTE1/P-D (Италия);

Выводы

1. По результатам УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ-анализов: при растворении лонгидазы изменений не происходит.

2. Действие импульсных токов сложной формы, получаемых на аппаратном комплексе «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модели FTE1/P-D (Италия) в заданном диапазоне, не влияет на физико-химические свойства растворов лонгидазы, вводимых в организм с использованием данного устройства.

Рекомендации

Для продолжения исследований на предмет влияния тока на химические структуры и свойства действующих веществ рекомендован метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с масс-детекцией. В случае необходимости определения структурных изменений строения молекул при гидролизе необходимо применять метод – H^1 -ЯМР-спектроскопию.

Заведующий лабораторией
фармакокинетики и контроля
качества лекарственных средств.
д.м.н., Заслуженный врач РФ



Г.Н. Шарапов

Ведущий специалист ЛФККЛС
в области хроматографии и спектроскопии

А.Л. Попов